

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

*Acta de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. LA-914010985-E5-2021 para la contratación del "SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO", de conformidad con lo que establece los artículos 33 y 33 Bis, de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 y 46 de su REGLAMENTO.*

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas, del día 12 de febrero de 2021, en el auditorio central del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sita en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro, C.P. 44100; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 3.8 **JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA** de la licitación.

Este acto fue presidido por el **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya**, Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, servidor público designado por la convocante **Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente el cual solventó las preguntas de carácter técnico, el representante del área contratante el cual solventó las preguntas de carácter administrativo y el representante del Órgano Interno de Control cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V	Presencial	13/ administrativas 12/técnicas Nota. El licitante relaciona el numeral 13, sin presentar pregunta.
2	Laboratorios Licon S.A.	Presencial	1/administrativa 7/técnicas
3	Internet, S.A. de C.V.	Presencial	6/administrativas 4/ técnicas

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo. (aplica si no se presentan observadores)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

A continuación, se dio lectura pormenorizada a la aclaración de la convocatoria por parte de la convocante, misma que deberá tenerse en cuenta por los licitantes cuando presenten las respectivas propuestas, ya que formará parte de la presente acta.

1. Aclaración a la convocatoria de conformidad con lo que establecen los artículos 33 y 33 bis, de la Ley.

NUMERO DE ACLARACIONES	PUNTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA	DICE:	DEBE DECIR:
1	8.2 Determinación de las penalizaciones. Instalación.	"Cuando el proveedor no haya instalado y puesto en operación los equipos nuevos para la prestación del servicio de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 Carta de requerimientos, en cualquiera de las unidades médicas hospitalarias incluidas dentro de los 90 días naturales a partir del fallo..."	"Cuando el proveedor no haya instalado y puesto en operación los equipos nuevos para la prestación del servicio de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, en cualquiera de las unidades médicas hospitalarias incluidas dentro de los <b>15 días naturales</b> a partir del fallo..."

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
1	1.1 Medios que se utilizarán en la Licitación.  Página 9 de 126	Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare si, derivado a la situación mundial de pandemia y a las propias restricciones del Gobierno sobre reuniones presenciales, se permite presentar proposiciones de manera electrónica ya que en la plataforma Compranet se encuentran activos todos los parámetros para subir archivos. ¿Se acepta?	No se acepta, el medio de participación de esta licitación es presencial, por lo que las proposiciones se deberán presentar por escrito en sobre cerrado de manera presencial de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria en el domicilio del Organismo, sita en Dr. Baeza Alzaga No. 107 colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
			<p>No se aceptarán propuestas presentadas por paquetería, mensajería o cualquier otro medio de comunicación remota.</p> <p>Se asegurarán en el acto los protocolos de sanidad recomendados motivados por la contingencia.</p>
2	1.9 Manuales o Catálogo.  Página 12 de 126	Solicitamos amablemente a la convocante de que, en caso de requerir referenciar características en un manual, nos permita integrar únicamente las hojas utilizadas, esto para facilitar la revisión por parte de la convocante e integrando carta bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicados se entregarán manuales completos. ¿se acepta?	Podrá integrar solamente las hojas del manual utilizadas para referenciar las características solicitadas en el Anexo 1, Carta de Requerimientos Técnicos, apartado 1-D y deberá integrar de manera digital los manuales completos de los equipos ofertados, en el que se integrará el índice referenciado con las características de los equipos ofertados, preferentemente resaltadas mediante un recuadro rojo.
3	3.9. Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.  Página 23 de 126	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar los documentos con firma autógrafa cuando sea solicitada por el formato y en los demás documentos tales como catálogos, registros, certificados, etc. Nos permita entregarlos rubricados en todas las páginas. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
4	4. Requisitos a cumplir.  Página de 29 de 126	Dice: "...toda vez que las propuestas presentadas de manera presencial deben ser incorporadas al sistema CompraNet..."  ¿Es correcto entender que las propuestas deberán ser incorporadas al sistema Compranet por el licitante? Favor de aclarar.	No, las propuestas deberán presentarse por escrito de manera presencial en sobre cerrado en el domicilio de la Convocante en el día y horario establecido para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.  De conformidad con las <i>Disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, LA UNIDAD COMPRADORA</i> deberá incorporar la información de las proposiciones presentadas a CompraNet .
5	8.2 Determinación de las penalizaciones. Instalación.  Página 62 de 126	Dice: "Cuando el proveedor no haya instalado y puesto en operación los equipos nuevos para la prestación del servicio de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 Carta de requerimientos, en cualquiera de las unidades médicas hospitalarias incluidas dentro de los 90 días naturales a partir del fallo..."  ¿Es correcto entender que se deberán instalar equipos nuevos?	Se aclara que los equipos a instalar deberán ser nuevos o máximo tener una antigüedad de tres años.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"


Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
6	8.2 Determinación de las penalizaciones. Instalación.  Página 62 de 126	Dice: "Cuando el proveedor no haya instalado y puesto en operación los equipos nuevos para la prestación del servicio de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 Carta de requerimientos, en cualquiera de las unidades médicas hospitalarias incluidas dentro de los 90 días naturales a partir del fallo..."  ¿Es correcto entender que se tiene un plazo de 90 días naturales para la instalación?	Esta pregunta se contesta con la aclaración 1 de la Convocante.
7	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación, m) Carta del fabricante.  Página 46 de 126	Solicitan carta en formato libre en papel membretado en la que señale que los equipos que se instalarán para prestar el servicio objeto de la presente licitación son nuevos.  ¿Es correcto tender que los equipos señalados en el Apartado 1 D del Anexo 1 Carta de requerimientos Técnicos deberán ser nuevos?	La Convocante hace la aclaración, que los equipos a instalar deberán ser nuevos o con una antigüedad no mayor a tres años.
8	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la	¿Es correcto entender que los certificados que se deberán entregar corresponden únicamente a los equipos descritos en el numeral 1D.  CARACTERISTICAS DE LOS	Los certificados de libre venta solo aplican para los equipos mencionados en el apartado 1D del Anexo 1 de Requerimientos Técnicos y



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
	Participación, ñ) Certificado de libre venta.  Página 80 de 126	EQUIPOS que cuenten con registro sanitario o publicación en el Diario oficial de la Federación? Favor de aclarar.	que cuenten con registro sanitario.
9	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación, o) Registros Sanitarios y Certificados de Libre Venta  Página 49 de 126	Solicitan documentación para los equipos señalados en el apartado 1B DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES y equipo.  Derivado a que este apartado corresponde únicamente a los CENTROS DE COLECTA ¿Es correcto entender que los documentos que se deberán entregar corresponden a los equipos descritos en el numeral 1D. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS? Favor de aclarar.	Es correcta su apreciación; los licitantes deberán adjunta a su propuesta técnica los registros sanitarios y los certificados de libre venta de los equipos relacionados en el apartado 1D <i>Características De Los Equipos</i> del anexo 1 <b>Carta de Requerimientos Técnicos.</b>
10	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación, o) Registros Sanitarios  Página 80 de 126	¿Es correcto entender que los certificados de libre venta se deberán anexar en el inciso ñ) y en el inciso o) se deberán integrar registros sanitarios y certificados de calidad ISO 13485? Favor de aclarar.	Es correcta su apreciación.

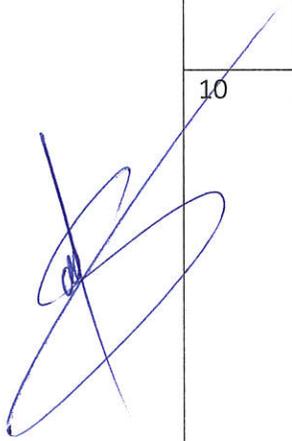LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
11	4. Requisitos a cumplir.  Página 30 de 126	¿Es correcto entender que bastará con integrar la siguiente leyenda a la Propuesta Económica: "La vigencia de la PROPOSICIÓN será hasta la conclusión de LA LICITACIÓN y en el supuesto de resultar adjudicado esta será vigente hasta la conclusión de la contratación"? Favor de aclarar.	El licitante deberá manifestar en su proposición económica que la vigencia de su PROPOSICIÓN será hasta la conclusión de LA LICITACIÓN y en el supuesto de resultar adjudicado esta será vigente hasta la conclusión de la contratación.  Además de agregar que los precios ofertados serán fijos hasta la conclusión de la vigencia de la contratación.
12	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación, m) Carta del fabricante.  Página 47 de 126	¿Se deberá entender que la carta del fabricante se deberá acompañar con copia certificada de la identificación oficial del firmante y copia certificada del Poder que le confiere el fabricante para la suscripción de documentos?	La convocante aclara que la carta del fabricante se deberá acompañar de copia simple de la identificación oficial del firmante y copia simple del poder que le otorga el fabricante para suscribir el documento.
13	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación, a)	¿Es correcto entender que se deberá integrar la siguiente leyenda: "la vigencia de la propuesta técnica será hasta la conclusión de la contratación", a todos los documentos en papel	El licitante deberá manifestar que la vigencia de su propuesta técnica será hasta la conclusión de <b>LA LICITACIÓN</b> y en el supuesto de resultar adjudicado esta será vigente hasta la conclusión de la contratación, se deberá asentar como parte del



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL


SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (Administrativas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
	Propuesta Técnica.  Página 40 de 126	membretado y firmados por el representante legal que conformen la Propuesta Técnica? Favor de aclarar	contenido del modelo de Formato 15 <b><u>Propuesta Técnica.</u></b>

**PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES**

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
1	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, Descripción detallada del servicio. Página 1.	Dice: "equipos nuevos (máximo 3 de años de antigüedad) con tecnología de última generación".  ¿Es correcto entender que se deberán instalar equipos nuevos con máximo 3 años de fabricación? Favor de aclarar.	Es correcta su apreciación, se deberán ofertar equipos nuevos con una antigüedad no mayor a tres años.
2	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 1.- Sistema Automatizado de Serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas. Página 37.	Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:  -Sistema automatizado de piso. -Con capacidad de recibir alimentación de muestras en acceso continuo al azar y programación de paneles. -Con capacidad de recibir hasta 135 muestras. -Con capacidad de recibir contenedores para muestras. -Con software en idioma español. -Software con la capacidad de registrar abordo tareas de mantenimiento. -Con la capacidad de llevar el mantenimiento diario. -Con la capacidad de acceso al software operativo vía remota.	Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 <i>Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i>

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Que cuente con un principio de medición por Quimioluminiscencia.</li> <li>-Con la capacidad de refrigeración abordo mínimo 25 posiciones de reactivos.</li> <li>-Identificación de muestras y reactivos a través de código de barras.</li> <li>-Con la capacidad de realizar una sola plataforma analítica la determinación para la identificación de la presencia del Antígeno de superficie de la Hepatitis B, la presencia Antígeno p24 del virus de la inmunodeficiencia humana y anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del tipo 1 (grupo M y O) y/o tipo 2 (VIH2), presencia de anticuerpos contra HCV, presencia de anticuerpos contra Trypanosoma Cruzi y presencia de anticuerpos contra Treponema Pallidum.</li> <li>-Reactivos, calibradores y controles líquidos y listos para su uso.</li> <li>-Que cuente con estabilidad de calibración de los reactivos.</li> <li>-Con una velocidad de análisis de 200 pruebas por hora.</li> <li>-Con la capacidad de utilizar volúmenes de muestra mínimo de 2 -200 µL, con un volumen muerto de 50 µL.</li> <li>-Con capacidad de verificar la presencia de coágulos y burbujas.</li> <li>-Capacidad de carga 135 muestras.</li> <li>-Con capacidad de interacción del usuario con el software a través de una pantalla a color y sensible al tacto.</li> <li>-Con capacidad para interfaz de manera bidireccional.</li> <li>-Con la capacidad de realizar gráficos de Levey-Jennings muestras de control de calidad.</li> </ul>	

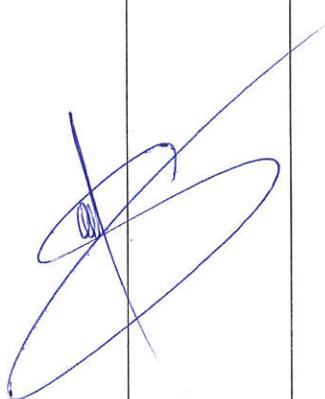


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"


Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		-Dispensación de muestras mediante dos brazos de pipeteo, no requiere puntas de plástico desechables. -Amigable con el medio ambiente (uso eficiente del recurso hídrico).	
		¿Se acepta?	
3	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 2.- Plataforma Automatizado para las pruebas cualitativas por Amplificación del Ácido Nucleico in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del ARN del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 (VIH-1 grupo M, VIH-1 grupo O, tipo VIH-2.), del ARN del virus de la Hepatitis C (HCV) y del ADN del virus de la Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT). Página 38.	Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:  -Equipo automatizado para determinar la amplificación y/o detección de ácidos nucleicos de microorganismos, en suero y/o plasma. -Tecnología de reacción en cadena de la polimerasa y la tecnología en tiempo real de la nucleasa. -Amplificación automatizada de ácido nucleico y detección automatizada en tiempo real de productos de PCR. -Análisis o estudios a determinar, para determinar la amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco) de microorganismos, en suero y/o plasma para la detección directa del ARN del Grupo M y O del virus de inmunodeficiencia humano tipo 1(HIV1) el ARN del grupo o del virus de Inmunodeficiencia humano tipo 2 (HIV2), ARN del virus de la Hepatitis C (HCV), y el ADN del virus de la hepatitis B (HBV). -Rango de lectura de longitud de onda de acuerdo al modelo y marca del equipo. -Velocidad de tiempo de lectura: (de acuerdo al volumen de muestras). -Capacidad de detección de copias por ml y/o IU/ml:	Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 <i>Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i>

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		<p>Para HIV-1 Grupo M 35.5 – 65.9 IU/ml            Para HIV-1 Grupo O 13.1 – 30.9 copias/ml            Para HIV-2 48.7 – 66.6 copias/ml            Para HCV 5.8 – 8.3 IU/ml            Para HBV 2.0 – 2.8 IU/ml            -Capacidad para trabajar con volúmenes de muestra: máximo 1000 microlitros.            -Controles y Reactivo de lavado incluidos            -Instalación: 120 o 220V/60Hz.            ¿Se acepta?</p>	
4	<p>Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 3.- Analizador para Biometría Hemática Tipo 1. Página 39</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:</p> <p>-Analizador automático para pruebas hematológicas, con 31 parámetros reportable y diferencial 6 partes. WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F); NEUT#, %; IG #, %; LYMPH #, %; MONO#, %; EO#, %; BASO #, %; NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF.            -Que cuente con sensor de aspiración de muestra. Capacidad de ensaye de 100 pruebas/hr. Reactivos libres de cianuro.            -Capacidad del sistema para programación y almacenamiento de pruebas de resultados de pacientes.            -Cuenta con los siguientes principios de medición: citometría de flujo fluorescente, corriente directa y enfoque hidrodinámico, método SLS libre de cianuro.            -Volumen de 88 µl de muestra.            -Obtención de resultados con reporte en gráficas, números absolutos o porcentos tanto en el</p>	<p>Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		<p>monitor del equipo como en el instrumento de impresión.</p> <p>-Lector de código de barras.</p> <p>-Con puerto de comunicación para interfaz. Pantalla o monitor integrado o externo.</p> <p>-Control de calidad interno a tres niveles y graficas de Levy Jennings.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
5	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 4.- Analizador para Biometría Hemática Tipo 2. Página 39	<p>Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:</p> <p>-Cuenta con 20 parámetros y diferencial de 3 partes.</p> <p>-Capacidad de procesamiento de mínimo 60 muestras por hora para muestras de sangre completa.</p> <p>-Tamaño de muestra de 20 µL muestras con diluyente prediluido, 60 µL en sangre total.</p> <p>-Que cuente con pantalla táctil para facilitar su uso.</p> <p>-Impresión y visualización en pantalla de histogramas.</p> <p>-Almacenamiento de 40,000 resultados de muestras con histogramas.</p> <p>-Impresora térmica incluida.</p> <p>-Puerto especializado para lector de código de barras y puerto para interface.</p> <p>-Principio de medición por método de detección por corriente directa y fotometría método libre de cianuro.</p> <p>-Estadísticas de control de calidad con gráficas de Levey-Jennings.</p> <p>-Interfaz del usuario en español.</p> <p>-Tubo abierto manual.</p> <p>-Parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT.</p>	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.

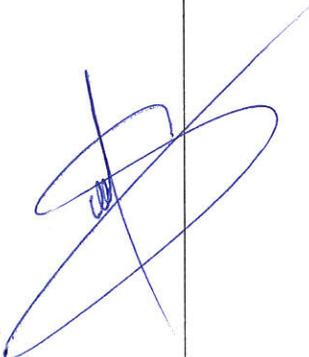


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		-Control de Calidad interno a 3 niveles. ¿Se acepta?	
6	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 6.- Analizador para la realización de Hemoglobina Libre. Página 41	Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas: -Fotómetro portátil con capacidad de realizar Pruebas de Hemoglobina Libre, a través de microcubetas desechables libres de reactivo y su almacenamiento no requiera refrigeración. -Proporcione resultados en menos de 2 segundos. -Que no requiera calibración por parte del usuario. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los participantes
7	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 11.- Equipo para la realización de Aféresis Plaquetaria / Procedimientos Especiales. Página 45	Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:  1.-Sistema automatizado para la recolección de componentes sanguíneos. 2.-Con programas para los siguientes procedimientos: recolección de plaquetas, recambios plasmáticos, y células mononucleares. 3.- Procesamiento de medula ósea (opcional). 4.-Que permita recolectar plaquetas, plasma y concentrado de eritrocitos. 5.-Que cuente con sensores ópticos y detectores para seguridad del donador. 6.-Sistema compuesto por centrifuga, tres bombas (bomba de anticoagulante, bomba de sangre y bomba de transferencia),	Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 <i>Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		<p>tecnología por tarjeta de protocolo para un acceso inmediato a múltiples procedimientos, escalas de solución y componentes.</p> <p>7.-Kit de aféresis desechable con sistema cerrado.</p> <p>8.-Pantalla que proporcione información durante los procedimientos. Se deberá incluir sellador externo.</p> <p>9.-Equipo compacto, portátil y liviano.</p> <p>10.-Sistema de unipunción.</p> <p>11.-Que permita controlar o calcular los siguientes parámetros: tiempo del procesamiento, productos a obtener en la donación, volumen extracorpóreo, volumen de recolección, tasa de infusión de anticoagulante, flujo de extracción y retorno.</p> <p>12.-Que cuente con múltiples sensores de aire.</p> <p>13.- Interfaz amigable con pantalla de ayuda interactivas.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
8	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, 14.- Fraccionadores automatizados. Página 47.	<p>Solicitamos amablemente a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar el siguiente equipo con características iguales o superiores a las solicitadas:</p> <p>1.- Separador automático para separar componentes sanguíneos a partir de sangre total centrifugada. Compacto y que no utilice compresor de aire adicional.</p> <p>2.- Con dos balanzas y extracción automática del aire, cabezales de sellado integrados y cálculo automático de la tara.</p> <p>3.- Con prensa controlada electrónicamente con movimiento en paralelo o inclinado. Capacidad de controlar presión, velocidad y</p>	<p>Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 <i>Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i></p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL  
SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
		<p>posición, retroalimentación con sensor óptico.</p> <p>4.- Con 16 programas cargados y posibilidad de crear un máximo de 40.</p> <p>5.- Con sistema de Balanzas integradas para determinar el peso de todos los componentes sanguíneos.</p> <p>6.- Con cinco pinzas de sellado programables para: cierre y/o soldadura de los tubos, con sensor de presencia del tubo que verifica su correcto posicionamiento, sujetador ubicado después del sensor óptico superior para detectar cambios en el estado del fluido que se desliza en el interior del tubo.</p> <p>7.- Con capacidad de conexión a un ordenador</p> <p>8.- Con ocho sensores ópticos en la prensa más uno exterior, todos con sensibilidad regulable independiente.</p> <p>9.- Con indicadores luminosos que indican el estado de los sujetadores y el sensor óptico principal.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
9	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, APARTADO B. Página 51-52	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita enviar las siguientes pruebas a un laboratorio de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pruebas confirmatorias para VHI 1/2 y para pruebas confirmatorias para HCV.</li> <li>- Prueba suplementaria de Anticuerpos Anti-Tripanosoma Cruzi.</li> <li>- Prueba suplementaria de Treponema.</li> </ul> <p>¿Se acepta?</p>	No se acepta, para este apartado el licitante deberá ofertar lo solicitado en el Anexo 1 carta de requerimientos técnicos de las bases de la licitación.
10	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, IV. PUESTO DE SANGRADO.	Solicitamos a la convocante aclare en cuántos CENTROS DE COLECTA se prestará el servicio, ya que mencionan siete, pero en la tabla	La convocante aclara que son 7 centros de colecta, por lo que se deberá de considerar el Centro de Colecta en Puerto

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES (Técnicas)			
No	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la Convocante
	Página 5	con direcciones solo aparecen seis. Favor de aclarar.	Vallarta, con domicilio calle Noruega #580 Col. Villas del real C.P. 48290, en la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco.
11	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, APARTADO 1 A, Pruebas confirmatorias. Página 20	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita enviar las siguientes pruebas a un laboratorio de referencia: - Pruebas confirmatorias para VHI 1/2 y para pruebas confirmatorias para HCV. - Prueba suplementaria de Anticuerpos Anti-Tripanosoma Cruzi. - Prueba suplementaria de Treponema. ¿Se acepta?	No se acepta, para este apartado el licitante deberá ofertar lo solicitado en el Anexo 1 carta de requerimientos técnicos de las bases a la licitación.
12	Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, APARTADO B. Página 51-52	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si se deberá entregar alguna documentación del apartado B, ya que en	De la información presentada en este número de aclaración, no se puede deducir la pregunta del licitante.
13	Unidad móvil		De la información presentada en este número de aclaración, no se puede deducir la pregunta del licitante.

LABORATORIOS LICON S.A.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN (administrativas)			
No.	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1	4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACIÓN BINARIA QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN. INCISO 0) REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD, CON FIRMADO PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE IDENTIFICAR	SE SOLICITA AMABLEMENTE LA CONVOCANTE QUE PARA LAQUELLOS INSUMOS Y/O EQUIPOS QUE DEBIDO A SU NATURALEZA NO REQUIEREN UN REGISTRO SANITARIO ME PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE LAQUELLOS PRODUCTOS QUE	Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

LO SIGUIENTE: MARCAR EPOR SU NATURALEZA, IDENTIFICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y LA FEDERACIÓN (DOF) EN EL LISTADO USO NO SE CONSIDERAN DE INSUMOS PARA LA SALUD COMO INSUMOS PARA LA CONSIDERADOS COMO DE BAJOSALUD Y POR ENDE NO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN REQUIEREN REGISTRO DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE "SANITARIO", PUBLICADO EN AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SUEL DIARIO OFICIAL DE LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS FEDERACIÓN EL 22 DE PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN DICIEMBRE DEL 2014 ¿SE COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y PORACEPTA NUESTRA ENDE NO REQUIEREN REGISTROPROPUESTA? SANITARIO.
---

**LABORATORIOS LICON S.A.**

**PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

NO.	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	Respuesta
1	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO EQUIPO NUEVOS (MÁXIMO 3 DE AÑOS DE ANTIGÜEDAD)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO ENCARECER EL SERVICIO ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3 A 5 AÑOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta de manera parcial, el licitante deberá ofertar equipos nuevos o con una antigüedad máxima de 3 años.
2	EN EL APARTADO 1 A Y 1B GRUPO SANGUÍNEO, TARJETAS DE GEL PARA GRUPO SANGUÍNEO ABO Y RH	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO DIRECTO E INVERSO SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR QUE SE REALICE EN UNA SOLA TARJETA, CONTENIENDO LAS DETERMINACIONES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, CONTROL RH, A1 Y B, TAL COMO LO ESTABLECE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, sin ser limitante para el resto de los licitantes
3	EN EL APARTADO 1 A SOLICITAN FENOTIPO DEL RH EN GEL, TARJETAS DE GEL PARA FENOTIPO DE RH.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PRUEBA SE DEBERÁ ENTREGAR TARJETA DE GEL PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, c, E, e) CON DETERMINACIÓN DE 2 PRUEBAS POR TARJETA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, sin ser limitante para el resto de los licitantes

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

4	EN EL APARTADO 1B Y 1C PARA LA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN TUBO SOLICITAN SUERO DE COOMBS MONOESPECÍFICO IGG-C3D.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LO REQUERIDO ES SUERO DE COOMBS POLI ESPECÍFICO IGG-C3D. <b>¿FAVOR DE ACLARAR?</b>	La convocante aclara que se solicita suero <b>COOMBS POLI ESPECIFICO IGG-C3D.</b>
5	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS <b>III.- DEFINICIONES DE TIPO DE BOLSA:</b> UNIDAD/ TIPO DE BOLSA "A": MATERIALES E INSUMOS PARA CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PRUEBAS DE SEROLOGÍA Y NAT E INMUNOHEMATOLOGÍA TERCER NIVEL Y CNTS, CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DE COMPONENTES SANGUÍNEOS. CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CORRECTO ENTENDER QUE DEBEMOS ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSAI-2012 EN EL PUNTO 15.1.4, ADICIONAL DEL PROGRAMA SOLICITADO DEL CNTS. <b>¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</b>	Las especificaciones y requisitos solicitados por el área requirente son mínimos, el licitante podrá ofertar características superiores si así lo considera conveniente, sin ser limitante para el resto de los participantes.
6	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, APARTADO 1B Y 1C	SE SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERÁ INCLUIR LA INSCRIPCIÓN ANUAL A UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNO DE LA CALIDAD PARA INMUNOHEMATOLOGÍA DE SEGUNDO NIVEL A LOS CENTROS DE COLECTA Y DEPÓSITOS TEMPORALES. <b>¿FAVOR DE ACLARAR?</b>	Se aclara que se deberá de incluir en la inscripción anual de un programa de evaluación externo de control de calidad de inmunohematología, que incluya tipificación ABO Y RH, RASTREO de anticuerpos irregulares y pruebas de compatibilidad tanto a los Centros de Colecta, como a los depósitos temporales, según corresponda.
7	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, APARTADO 1A, 1B Y 1C	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI PARA EL APARTADO 1A, 1B Y 1C ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DEL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD, EL CUAL DEBE	Las especificaciones y requisitos solicitados por el área requirente son mínimos, el licitante podrá ofertar características superiores si así lo considera conveniente, sin ser limitante para el resto de los participantes.








		<p>CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD (EMA), EN LAS ÁREAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, SEROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSAI-2012 EN EL PUNTO 15.1.4 ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</p>	
--	--	---	--

Intermet, S.A. de C.V.			
Preguntas relacionadas con la Licitación/Administrativas			
No.	Numeral específico de la LICITACIÓN	Pregunta y/o aclaración	Respuesta de la convocante
1	4.3 Requisitos Económicos. A. Propuesta Económica y Formato 25. Propuesta Económica. Página 50	Para cumplir con los numerales indicados en este punto, solicitamos nos permita agregar al Formato 25, todos aquellos datos no contemplados originalmente, incluidas las columnas cantidades mínimas y máximas. ¿Se acepta mi propuesta?	Se acepta su propuesta, el (los) licitante(s) podrá (n) reproducir los modelos de formatos anexos a la convocatoria, en el modo en que estimen conveniente siempre y cuando sean legibles <b>y contengan la información solicitada</b> en las bases de la convocatoria, asimismo considerando los requisitos enunciados como obligatorios que afectan la solvencia de la proposición.
2	3.9. Del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Párrafo 5	Solicitamos a la convocante que, para el foliado de la propuesta técnica, permita asignar folio independiente a cada una de las carpetas	Se acepta su proposición, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

		que la integren. ¿Se acepta?	los documentos que entregue el licitante.
3	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación. Inciso n) Catálogos, manuales u hojas técnicas.	<i>Solicitamos a la convocante nos permita integrar solamente las hojas de manual que se utilicen para referenciar las características solicitadas de los equipos del apartado 1D. E integrar una memoria USB con los manuales completos en formato digital. Esto con la finalidad de disminuir la cantidad de hojas impresas y sea más ágil la revisión de nuestra propuesta. ¿Se acepta nuestra propuesta?</i>	Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.
4	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación. Inciso ñ) Certificado de libre venta.	<i>Entendemos que los certificados de libre venta aplican solo para los equipos mencionados en el apartado 1D del Anexo 1 de los equipos solicitados en el apartado 1D y que cuenten registro sanitario. ¿Es correcta nuestra apreciación?</i>	Los certificados de libre venta solo aplican para los equipos mencionados en el apartado 1D del Anexo 1 de los equipos solicitados en el apartado 1D y que cuenten con registro sanitario.
5	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación. Inciso o) Registros Sanitarios y Certificado de libre venta.	<i>Entendemos que los registros sanitarios e ISO 13485 solicitados solo aplican en este inciso aplican solamente para los equipos solicitados en el apartado 1D. ¿Es correcta nuestra apreciación?</i>	Los registros sanitarios e ISO 13485 solicitados solo aplican para los equipos mencionados en el apartado 1D del Anexo 1 de los equipos solicitados en el apartado 1D. ¿Es correcta nuestra apreciación?
6	4.2. Requisitos Técnicos Obligatorios para la Evaluación Binaria que Afectan la Participación. Inciso o) Registros Sanitarios y Certificado de libre venta.	<i>Entendemos que en caso de que los bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, se deberá presentar constancia oficial expedida por la Secretaría de Salud,</i>	Es correcta su apreciación, deberá integrar copia de las páginas del DOF del 22 de diciembre 2014 en donde se mencionen los insumos y equipos que por ende no requieren registro sanitario o copia de la constancia oficial

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

	<p>con firma autógrafa y expedida por la Secretaría de Salud. público que la emite, que lo exima del mismo o Diario Oficial de la Federación (DOF) en el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario, identificando claramente el bien ofertado. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
--	--	--

**Internet, S.A. de C.V.**

**Preguntas relacionadas con las especificaciones técnicas**

No. de pregunta y/o aclaración	Numeral de las especificaciones técnicas	Pregunta y/o aclaración	Aclaraciones de la Convocatoria.
1	<p>Númeral VI. Unidad móvil para campañas de donación altruista extramuros.</p>	<p>Solicitan copia de la tarjeta de circulación vigente y una copia certificada para sus especificaciones de la cotejo. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita integrar este documento en la cedula de especificaciones de la cotejo, con una unidad móvil del</p>	<p>El documento solicitado deberá integrarse en la cédula de especificaciones de la unidad móvil del apartado 1D, integrando copia de la tarjeta de circulación y copia certificada para su especificaciones de la cotejo, con una</p>

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

		<i>apartado 1D. ¿Se acepta nuestra propuesta?</i>	<i>antigüedad no mayor a dos años.</i>
2	Apartado 1D. 1.- Sistema Automatizado de Serología para la determinación de HIV Ag/Ac, HCV, HBsAg, Sífilis y Chagas.	<i>Entendemos que al mencionar que el equipo sea amigable con el medio ambiente (uso eficiente del recurso hídrico). Se refiere a que no utilice agua para su funcionamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</i>	<i>Es correcta su apreciación, el equipo deberá cumplir con el uso eficiente de los recursos hídricos.</i>
3	Apartado 1D. Balanza mezcladora.	<i>La convocante solicita "Balanza agitadora informatizada para las donaciones de sangre". Entendemos que se refiere a "Balanza agitadora automatizada para las donaciones de sangre" ¿Es correcta nuestra apreciación?</i>	<i>El equipo solicitado por la convocante es una Balanza agitadora automatizada para donaciones de sangre.</i>
4	Apartado B. PRUEBAS SEROLOGICAS MANUALES DESCRIPCION TECNICA.	<i>Dado que los apartados C y D del Anexo 1 son escritos bajo protesta de decir verdad. Entendemos que el apartado B también bastará con presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde mi representada se compromete a proporcionar lo señalado en dicho apartado ¿Es correcta nuestra apreciación?</i>	<i>Es correcta su apreciación, sin ser un limitante para el resto de los participantes.</i>

Se informa a los licitantes presentes que cuentan con un plazo de 20 minutos, para formular y entregar de manera presencial las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, a las que se les dará contestación, una vez concluido el término señalado con anterioridad en el lugar donde se está llevando a cabo el acto.

Una vez concluido el término anterior, el presidente del acto declara la continuidad del mismo, recibiendo las preguntas de las respuestas emitidas por la CONVOCANTE, de los Licitantes Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V y LABORATORIOS LICON S.A., dando contestación como a continuación se detalla.

Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V			
No.	Referencia de la respuesta otorgada por la convocante	Pregunta	Respuesta
1	Respuesta de la CONVOCANTE a la pregunta técnica número 1 ( <i>Es correcta su apreciación, se deberán ofertar equipos nuevos con una antigüedad no mayor a tres años.</i> )	Solicitamos amablemente a la CONVOCANTE nos aclare si los equipos deberán ser nuevos, sin ningún uso, demostrando su fabricación menor a tres años con pedimentos de importación.	Los equipos tendrán que ser nuevos o equipos usados, que se encuentren en óptimas condiciones, con una antigüedad de fabricación de máximo 3 años, acreditando dicha condición de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA.
2	Respuesta de la CONVOCANTE a la pregunta técnica número 2 ( <i>Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i> )	¿Es correcto entender que se acepta el equipo propuesto como opción?	Reiteramos que las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, por lo que los licitantes podrán ofertar cualquier equipo que se ajuste a lo solicitado.
3	Respuesta de la CONVOCANTE a la pregunta técnica número 7 ( <i>Las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, los licitantes podrán oferta cualquier equipo que se ajuste a los solicitado.</i> )	¿Es correcto entender que se acepta el equipo propuesto como opción?	Reiteramos que las especificaciones y requisitos señalados en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos solicitados por el área requirente son mínimos, por lo que los licitantes podrán ofertar cualquier equipo que se ajuste a lo solicitado.

LABORATORIOS LICON S.A.			
No.	Referencia de la respuesta otorgada por la convocante	Pregunta	Respuesta
1	Respuesta de la CONVOCANTE a la pregunta técnica número 1 <i>(Se acepta de manera parcial, el licitante deberá ofertar equipos nuevos o con una antigüedad máxima de 3 años.)</i>	Solicito atentamente a la CONVOCANTE favor de aclarar respuesta: "se acepta parcialmente".	Los equipos tendrán que ser nuevos o equipos usados, que se encuentren en óptimas condiciones, con una antigüedad de fabricación de máximo 3 años, acreditando dicha condición de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA. En atención a lo anterior es que se acepta parcialmente, dado que se aceptarán equipos de hasta 3 años de fabricación como máximo.

Se pregunta a los asistentes a este acto si tienen alguna duda o manifestación que hacer constar a lo que responden que **no**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en los estrados de la Coordinación de Adquisiciones del ORGANISMO un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se informa a los presentes que **no** se registró ninguna persona como observador.

Se les recuerda a los licitantes que el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas se realizará de manera presencial el 22 de febrero de 2021 a las 12:00 horas en el Auditorio del Organismo, sita en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

No se aceptarán proposiciones a través de paquetería o mensajería, así como tampoco a través de medios de comunicación remota.


No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 10:31 horas, del día 12 del mes febrero del año 2021.

Esta Acta consta de 25 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
LA 914010985-E5-2021 PRESENCIAL

SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

**POR PARTE DEL ORGANISMO:**

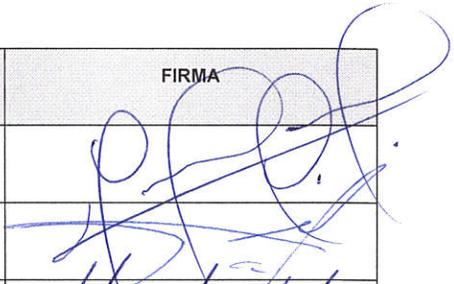SERVIDOR PÚBLICO	DEPENDENCIA	FIRMA
L.P. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA	O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	
MTRA. MARTHA VELÁZQUEZ ORTEGA	O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	
LIC. ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LOPEZ	O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	
DR. PATRICIA ARACELI DE LA MORA LÓPEZ	TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIONES SANGUÍAS DE JALISCO	
QFB. ARMANDO BENJAMÍN GODÍNEZ GUZMÁN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIONES SANGUÍAS DE JALISCO	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

NOMBRE	ORGANO INTERNO DE CONTROL	FIRMA
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	

**POR PARTE DE LOS LICITANTES:**

NOMBRE DEL LICIANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Laboratorios Lincon, S.A.	Diana Berenice García Badillo	
Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V	Marisol Camarena Bermúdez	

-----FIN DEL ACTA-----